



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области»
(ФБУ «Самарский ЦСМ»)

П Р И К А З

02 февраля 2024г.

г. Самара

№ 37

**О внесении изменений в Прейскурант на оказание (выполнение)
услуг (работ)**

В целях оказания услуг по метрологическому обеспечению единства измерений, **приказываю:**

1 Внести изменения в Прейскурант ФБУ «Самарский ЦСМ» на оказание (выполнение) услуг (работ) по метрологическому обеспечению единства измерений, изложив их в редакции согласно приложению.

2 Начальнику отдела автоматизированных систем управления Пронину С.Е. разместить настоящий приказ на официальном сайте ФБУ «Самарский ЦСМ».

3 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

О.Н. Жадаев

Приложение №1

к приказу ФБУ "Самарский ЦСМ"

от 01.02.2024 № 37

Код для загрузки	Комплект	Вид работ	Наименование	Тип СИ	Номер госреестра	Метрологический характер	Погрешность кратко	Гос заказ	Цена
------------------	----------	-----------	--------------	--------	------------------	--------------------------	--------------------	-----------	------

Новые введенные, измененные на 01.02.2024


000000009937	Нет	Поверка	Анализаторы спектра	R&S FSP	26744-04			Нет	26 694
000000009937	Нет	Калибровка	Анализаторы спектра	R&S FSP	26744-04			Нет	26 694
000000040788	Нет	Калибровка	Анализаторы спектра	FSH13, FSH20	57849-14			Нет	26 694
000000040788	Нет	Поверка	Анализаторы спектра	FSH13, FSH20	57849-14			Нет	26 694
000000042694	Нет	Калибровка	Анализаторы спектра	R&S FSP3, R&S FSP7, R&S FSP13,	26744-09			Нет	26 694
000000042694	Нет	Поверка	Анализаторы спектра	R&S FSP3, R&S FSP7, R&S FSP13,	26744-09			Нет	26 694
000000006628	Нет	Поверка	Анализаторы спектра	HP 8593 E	16241-97			Нет	18 396
000000006628	Нет	Калибровка	Анализаторы спектра	HP 8593 E	16241-97			Нет	18 396
Г00000001582		Поверка	Анализаторы спектра до 3 ГГц					Нет	18 396
Г00000001582		Калибровка	Анализаторы спектра до 3 ГГц					Нет	18 396
Г00000001581		Калибровка	Анализаторы спектра до 40 ГГц					Нет	26 694
Г00000001581		Поверка	Анализаторы спектра до 40 ГГц					Нет	26 694
000000048504	Нет	Поверка	Анализаторы электрических цепей и сигналов комбинированные портативные	FieldFox N9913A, FieldFox N9914A, FieldFox N9915A, FieldFox N9916A, FieldFox N9917A, FieldFox N9918A,	53569-13			Нет	26 694
000000048504	Нет	Калибровка	Анализаторы электрических цепей и сигналов комбинированные портативные	FieldFox N9913A, FieldFox N9914A, FieldFox N9915A, FieldFox N9916A, FieldFox N9917A, FieldFox N9918A,	53569-13			Нет	26 694
Г00000001587		Поверка	Аттенюаторы до 1 ГГц					Нет	4 404
Г00000001587		Калибровка	Аттенюаторы до 1 ГГц					Нет	4 404
Г00000001586		Поверка	Аттенюаторы до 18 ГГц					Нет	10 044
Г00000001586		Калибровка	Аттенюаторы до 18 ГГц					Нет	10 044
000000006664	Нет	Калибровка	АТТЕНУАТОРЫ	TR-1, BM 577				Нет	4 404
000000006664	Нет	Поверка	АТТЕНУАТОРЫ	TR-1, BM 577				Нет	4 404
000000008419	Нет	Калибровка	АТТЕНУАТОРЫ					Нет	10 044
000000008419	Нет	Поверка	АТТЕНУАТОРЫ					Нет	10 044
000000010321	Нет	Поверка	Ваттметры	GPM-8212	22451-08			Нет	9 990
000000010321	Нет	Калибровка	Ваттметры	GPM-8212	22451-08			Нет	9 990
000000008420	Нет	Калибровка	ВАТТМЕТРЫ ИМПОРТНЫЕ ДО 4	NRP, AGILENT				Нет	8 472
000000008420	Нет	Поверка	ВАТТМЕТРЫ ИМПОРТНЫЕ ДО 4	NRP, AGILENT				Нет	8 472
000000007023	Нет	Калибровка	Ваттметры с преобразователями	N1911A, N1912A (ваттметры); N1921A,	44086-10			Нет	12 546
000000007023	Нет	Поверка	Ваттметры с преобразователями	N1911A, N1912A (ваттметры); N1921A,	44086-10			Нет	12 546
Г00000001584		Калибровка	Измерители мощности					Нет	12 546
Г00000001584		Поверка	Измерители мощности					Нет	12 546
Г00000001585		Калибровка	Измерители мощности					Нет	8 472
Г00000001585		Поверка	Измерители мощности					Нет	8 472
Г00000001580		Калибровка	Измерители мощности					Нет	9 990
Г00000001580		Поверка	Измерители мощности					Нет	9 990
000000009413	Нет	Поверка	Измерители напряжения	ЭК0200	12005-11			Нет	2 883
000000009413	Нет	Калибровка	Измерители напряжения	ЭК0200	12005-11			Нет	2 883
0000000049127	Нет	Поверка	Измерители напряжения	ЭК0200	12005-89			Нет	2 883
0000000049127	Нет	Калибровка	Измерители напряжения	ЭК0200	12005-89			Нет	2 883
Г00000001553		Поверка	Измерители напряжения					Нет	2 883
Г00000001553		Калибровка	Измерители напряжения					Нет	2 883
0000000051291	Нет	Калибровка	Измерители электрической	GPM-78213	72372-18			Нет	9 990
0000000051291	Нет	Поверка	Измерители электрической	GPM-78213	72372-18			Нет	9 990
0000000051305	Нет	Поверка	Концентраторы-анализаторы	СКМ-8	55968-13			Нет	18 396
0000000051305	Нет	Калибровка	Концентраторы-анализаторы	СКМ-8	55968-13			Нет	18 396
Г00000001583		Калибровка	Преобразователи					Нет	18 396
Г00000001583		Поверка	Преобразователи					Нет	2 364
000000018237	Нет	Калибровка	Преобразователи	ЭП 8509	17961-98			Нет	2 364
000000018237	Нет	Поверка	Преобразователи	ЭП 8509	17961-98			Нет	2 364
000000007374	Нет	Калибровка	Приборы для исследования	X1-46	5050-75			Нет	4 854
000000007374	Нет	Поверка	Приборы для исследования	X1-46	5050-75			Нет	4 854
Г00000001588		Калибровка	Приборы для исследования АЧХ					Нет	4 854
Г00000001588		Поверка	Приборы для исследования АЧХ					Нет	4 854
000000037971	Нет	Поверка	Серверы синхронизации	ССВ-1Г	58301-14			Нет	13 236
000000037971	Нет	Калибровка	Серверы синхронизации	ССВ-1Г	58301-14			Нет	13 236
000000037971	Нет	Калибровка выезд	Серверы синхронизации	ССВ-1Г	58301-14			Нет	14 160
000000037971	Нет	Поверка выезд	Серверы синхронизации	ССВ-1Г	58301-14			Нет	14 160
000000002018	Нет	Калибровка выезд	Устройства синхронизации	УСВ-1	28716-05			Нет	14 160
000000002018	Нет	Поверка	Устройства синхронизации	УСВ-1	28716-05			Нет	14 160
000000002018	Нет	Поверка выезд	Устройства синхронизации	УСВ-1	28716-05			Нет	14 160
000000002018	Нет	Калибровка	Устройства синхронизации	УСВ-1	28716-05			Нет	14 160
Г00000001589		Калибровка выезд	Устройства синхронизации					Нет	13 236
Г00000001589		Поверка выезд	Устройства синхронизации					Нет	14 160
Г00000001589		Калибровка	Устройства синхронизации					Нет	14 160
Г00000001589		Поверка	Устройства синхронизации					Нет	13 236

Аннулированные тарифы на 01.02.2024

000000046857	Нет	Поверка	Барометры образцовые переносные	БОП-1М (логисты)	26469-17	Диапазон измерений: в полном объеме	в соответствии с описанием типа	Нет	
000000044058	Нет	Поверка	Дозаторы пипеточные	Eppendorf Research Plus	55543-13			Нет	
000000041939	Нет	Поверка	Колонки газораздаточные	EMB, EMC, EMD	33424-06			Нет	
000000018203	Нет	Поверка	Преобразователи давления	ПФД-АII	69120-17	Диапазон	менее 0.1%	Нет	
000000042629	Нет	Поверка	Преобразователи давления	ПФД-АII	69120-17			Нет	
000000044977	Нет	Поверка	Приборы универсальные	A565	8911-86			Нет	

Заместитель директора

Начальник ПЭО

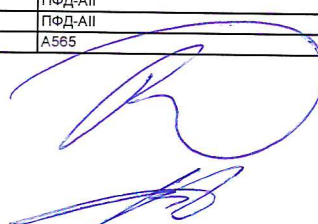

А.А. Бодягин

Е.А. Антипов